

Szczecin, dn. 21.03.2014 r.

Znak sprawy: ZP/220/39/14

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę jednorazowych elektrod endokawitarnych do czasowej stymulacji serca oraz kaset do sterylizatora plazmowego Sterrad 100S.

WYJAŚNIENIE NR 1


W związku z wpływieniem do Zamawiającego pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Dotyczy pakietu nr 4

Prosimy o dopuszczenie również elektrod endokawitarnych, od producenta z USA, w rozmiarze 4F, 5F oraz 6F (bez obecnie wymaganego rozmiaru 7F) o długość roboczej 110cm i długości całkowitej 125cm, odstęp między pierścieniami elektrody 10mm.

Pozytywna odpowiedź na pytanie poszerzy grono oferentów co wpłynie na obniżenie ceny oferowanych produktów. Obecnie wymagana elektroda 7F znacznie ogranicza grono oferentów a przy tym z uwagi na swój rozmiar 7F i dużą średnicę zewnętrzną jest elektrodą dość inwazyjną.

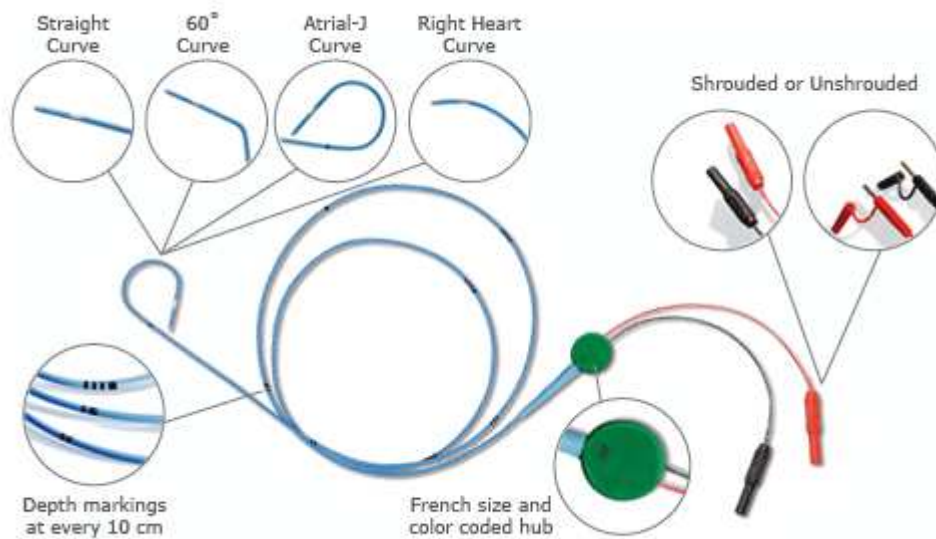

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający, biorąc pod uwagę potrzeby wynikające z operacji specjalistycznych, w SIWZ precyzyjnie określił przedział rozmiarów.

Zamawiający niniejszym pismem nie wprowadził zmiany do SIWZ, które wymagają dodatkowego czasu na dokonanie zmian w przygotowywanych ofertach. **Zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert.** Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.

Z poważaniem