

znak sprawy: ZP/220/96/15

Szczecin, dnia 27-11-2015r

w sprawie: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa obłożeń do zabiegów angiografii i urologii oraz worków urologicznych wraz z dzierżawą stelaża

**Wyjaśnienia 1**

W związku z wpływaniem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1****Zadanie 3 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następujących parametrach technicznych:

- 1 szt. - serweta na stolik-150cm x 190cm
- 1 szt.- serweta do resekcji przezcewkowej z otworem brzuszny 6cm i kroczy 6cm, osłoną palca do badania per rectum, torebką do zbiórki płynów ze sztywnikiem, filtrem, końcówką odpływową. Osłona na kończyny zintegrowana z całością serwety- 190cm x 230cm
- 1 szt. -taśma przylepna-10cm x 50cm
- 4 szt.- serwetka chłonna do rąk-30cm x 30cm

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 2****Zadanie 3 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o gramaturze 51g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 3****Zadanie 3 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw zgodnie z wymogami normy PN EN13795.

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 4****Zadanie nr 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu zawierającego w swoim składzie 2xręczniki celulozowe w rozmiarze 30x20cm zamiast min.30x30cm. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 5****Zadanie nr 2 pozycja 1**

Prosimy o sprostowanie:

Dot. punktu 6 Parametrów technicznych

Czy Zamawiający wymaga długości rozciągniętego spustu 1625 mm?

W obecnym zapisie długość spustu skompresowanego jest krótsza niż rozciągniętego.

**Odpowiedź**

**Zamawiający wyjaśnia, że prawidłowa długość wynosi 1625mm**

**Pytanie nr 6**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 1 w pozycji 1 trójwarstwowej serwety do angiografii, o układzie warstw: włóknina polipropylenowa, folia PE, włóknina wiskozowa. Serweta w rozmiarze 220x320 cm z dwoma otworami Ø 9 cm (folia operacyjna na brzegach otworu) i obustronną, przezroczystą osłoną na pulpit w rozmiarze 60x320 cm.

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 7**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 1 w pozycji 1 serwety dwuwarstwowej 75x100 cm z samoprzylepnym otworem 6x8 cm.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 8**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 1 w pozycji 1 fartucha wzmocnionego w rozmiarze XL, wykonanego z włókniny typu SMS z nieprzemakalnymi wstawkami w części przedniej i na rękawach, chroniącymi przed przenikaniem płynów, u góry zapinane na rzep, rękawy wykończone elastycznym, bawełnianym mankietem, szwy ultradźwiękowe, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja pozwalają na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu i jak z tyłu operatora.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 9**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 1 w pozycji 1 osłony na sprzęt medyczny w rozmiarze 120x100 cm.

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 10**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 1 w pozycji 1 i 2 okrągłej osłony na sprzęt medyczny w rozmiarze 60x50 cm, wykonanej z folii PE.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 11**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 1 w pozycji 1 serwety gazowej, 4 warstwowej z czipem RTG i tasiemką, w kolorze białym, wstępnie prana w rozmiarze 50x60 cm.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 12**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 1 w pozycji 1 patyków do dezynfekcji w rozmiarze 4,5-5cm x 4,5-5cm na plastikowej szpatułce.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 13**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 1 w pozycji 1 pojemnika plastikowego, okrągłego o pojemności 2500 ml?

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 14**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 1 w pozycji 1 pojemnika plastikowego, prostokątnego o pojemności 3000 ml, niebieskiego w rozmiarze 24x31x7 cm.

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 15**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 1 w pozycji 1 miski/pojemnika plastikowego o pojemności 250 ml z podziałką, w kolorze niebieskim.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 16**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 1 w pozycji 2 fartucha w rozmiarze L, wykonanego z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, bawełnianym mankietem, szwy ultradźwiękowe, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja pozwalają na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu i jak z tyłu operatora.

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 17**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 3 w pozycji 1 taśmy przylepnej w rozmiarze 10x50 cm.

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 18**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 3 w pozycji 1 serwety do TUR 175/290x250 cm, z zintegrowanymi nogawicami, z przylepnym otworem brzuszным Ø 9 cm, z otworem na pręcie Ø 5cm, osłoną na palec, z torbą na płyny z filtrem i portem ssaka, torba wyposażona w sztywnik umożliwiający modelowanie brzegów. Serweta wykonana z jednorodnego, chłonnego i wytrzymałego dwuwarstwowego laminatu (polipropylen, polietylen), pozbawiona pyłących włókien celulozy i wiskozy. Gramatura serwety min. 61 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie płynów min. 900 cm H<sub>2</sub>O, odporność na rozzerwanie na mokro/sucho min. 150 kPa.

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 19**

**Zadanie nr 1**

Poz. nr 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do angiografii zgodnego z wymaganiami SIWZ, jednakże w którym w serwecie do angiografii, osłona na pulpit przezroczysta obustronnie ma rozmiar 60 x 300cm, 2 patyki do dezynfekcji są na plastikowej szpatułce, pojemnik plastikowy, prostokątny 3000 ml ma wymiary 29 x22 x7,5 cm, natomiast pojemnik plastikowy 250 ml ma wymiary 9,2 x 5,5 cm

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 20**

**Zadanie nr 1**

Prosimy o dopuszczenie obłożeń zawierających pojemnik niebieski 3000 ml okrągły zamiast prostokątnego, pojemnik plastikowy okrągły 250 ml w kolorze czerwonym zamiast niebieskiego oraz miskę 500 ml zamiast kubka plastikowego, spełniających pozostałe wymagania SIWZ.

Proponowana przez nas zmiana parametrów nie wpłynie z całą pewnością na walory użytkowe fartuchów oraz poziom bezpieczeństwa personelu i pacjenta a umożliwi złożenie oferty większej liczbie oferentów co wpłynie korzystnie na sytuację finansową szpitala. Oferowane przez nas fartuchy spełniają wszystkie wymagania normy PN-EN 13795 1-3, dotyczącej obłożeń chirurgicznych, fartuchów chirurgicznych i odzieży dla bloków operacyjnych stosowanych jako wyroby medyczne dla pacjentów, personelu medycznego i wyposażenia.

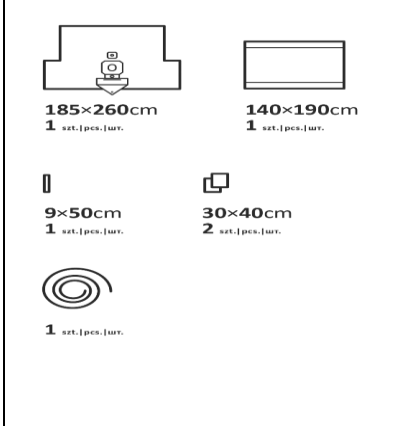
**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

### **Pytanie 21**

Pytanie nr 1 - Zadanie 3 :

a) Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu do zabiegów urologicznych (dren) o następującym składzie i parametrach: – serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o gramaturze 62 g/m<sup>2</sup>. Odporność materiału na przeniknięcie cieczy – min. 150 cm H<sub>2</sub>O, odporność na rozerwanie na mokro/sucho min.170kPa. Skład :

	<i>Asortyment:</i>	<i>Ilość:</i>	<i>Rozmiar:</i>
	Serweta na stolik instrumentariuszki	1 sztuka	140x190
	Serweta urologiczna ze zintegrowanymi nogawicami, z torbą na płyny z sitem i zaworkiem spustowym.	1 sztuka	185x260x200
	z samoprzylepnym oknem nadłonowym	1 sztuka	φ7
	z samoprzylepnym oknem do obłożenia okolic krocza	1 sztuka	7x10
	z bezlateksową osłoną na palec	1 sztuka	φ3
	Dren	1 sztuka	1,5 m
	Taśma samoprzylepna	1 sztuka	9x50
Ręcznik	2 sztuki	30x40	

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier” posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone ma być dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Zgodność z normami MDD 93/42, **PN EN 13795 : 2011** , EN ISO 11135 -1: 2007 oraz EN 556 – 1:2001

Lub

b) Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu do zabiegów urologicznych o takim samym składzie i parametrach jak opisany powyżej ale bez drenu?

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

### **Pytanie 22**

**Dotyczy wzoru umowy**

Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do wysokości 0,2% w § 10. ust. 1 lit. a. Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za wygórowane i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do ewentualnych naruszeń. Ponadto, w przypadku obniżenia wysokości kar umownych interes Zamawiającego nie zostanie zagrożony, ponieważ ma możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację**

### **Pytanie 23**

**Dotyczy wzoru umowy**

Prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu § 1. ust. 13 o następującej treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację**

### **Pytanie 24**

**Zapytanie I - dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Zadaniu nr 3:**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów urologicznych w składzie:

1. serweta chirurgiczna do przezcewkowych zabiegów urologicznych o wymiarach 175/270x180 cm zintegrowana z nogawicami, posiadająca otwór samoprzylepny w okolicy jamy brzusznej (Ø 8 cm), otwór na prącie (Ø 5 cm) i osłoną na palec do badania per rectum. Serweta posiada worek do przechwytywania płynów z sitem, wraz z trokami do jego regulacji, oraz przewód do odprowadzania płynów .....	175x270x180	1
2. ręcznik chłonny .....	18x25	1
3. samoprzylepny organizator przewodów .....	9x18	1
4. serweta na stół - (owinięcie zestawu) .....	150x190	1

wykonany z 2-warstwowego laminatu ( folia PE o grubości 50 mikronów i włókniny celulozowej o gramaturze 20 g/m<sup>2</sup> ), nieprzemakalności > 140 cm H<sub>2</sub>O , odporności na rozerwanie w strefie krytyczne na sucho/mokro 175/110 kPa. Zestaw pakowany w worek folia/folia z 2 odlepnymi etykietami spełniający wymagania wysokich procedur wg normy 13795 1-3?

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 25**

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację**

**Pytanie 26**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 10 ust. 1:

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Sprzedawca, Kupującemu przysługują kary umowne w następującej wysokości:

a) w przypadku opóźnienia w dostarczeniu Kupującemu zamówionej partii wyrobów lub opóźnienia w dostarczeniu wyrobu wolnego od wad w wysokości 0,5% wartości brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od wartości brutto zamówionej lub zareklamowanej partii wyrobów, jednak nie mniej niż 50 zł za każdy dzień opóźnienia oraz nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej/wadliwej partii wyrobów

b) w przypadku opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu dokumentów o których mowa w § 2 w wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto części dostawy, której dotyczą niedostarczone dokumenty

c) w przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy w całości bądź w zakresie poszczególnych zadań z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Sprzedawca bądź rozwiązania umowy przez Kupującego w drodze wypowiedzenia (§ 14 umowy) – w wysokości 10% wartości brutto części umowy (wartości zadania) określonej w § 6 umowy/formularzu cen jednostkowych.

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację**

**Pytanie 27**

Czy zamawiający w zadaniu 3 pozycja 1 dopuści Obłożenie do zabiegów urologicznych w składzie:  
 -obłożenie do TUR o wymiarach 152cm x 164cm, posiadające w części kroczonej elastyczny otwór oraz palec do badania per rectum wykonany z neoprenu, w części brzusznej – otwór o średnicy 6cm; zintegrowane z osłonami na kończyny oraz zbiornikiem na płyny wraz z filtrem i zaworem z możliwością podłączenia ssaka; zbiornik wyposażony w przyklepic od strony zewnętrznej umożliwiający stabilizację zbiornika przez przyklejenie do fartucha operatora,  
 - serweta na stół instrumentariuszki 200cm x 150cm  
 - 4 serwetki do rąk

Materiał obłożeń i serwet: materiał z włókien sztucznych, dwuwarstwowy (polipropylen i polietylen - laminat) , bez dodatku wiskozy i celulozy; gramatura materiału : 60 g/m<sup>2</sup>; I klasa palności wdl 16 CFR 1610; materiał niepylący, chłonny, odporny na działanie alkoholi, antystatyczny, materiał

jednakowo, wysoce absorpcyjny na całej powierzchni, bez wydzielonych stref krytycznych i mniej krytycznych (całość traktowana jako strefa krytyczna); bez dodatku lateksu; zastosowany klej akrylowy, hypoalergiczny, repozycjonowalny (umożliwiający swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału); obłożenia i serwety spełniają wymogi Normy EN 13 795 dla materiałów o podwyższonym standardzie w obszarze krytycznym; minimalna odporność na przenikanie płynów 150cm H<sub>2</sub>O; zestaw pakowany w opakowaniu typu MultiVac (torba papierowo-foliowa z częścią foliową dostosowaną do wypukłości pakietu); na opakowaniu podwójna , samoprzylepna metka z kodem kreskowym, nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do prowadzenia dokumentacji medycznej.

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia oraz zapisy podczas sporządzania i składania ofert.**

*Z poważaniem*

.....  
*DYREKTOR SPSK-2*